Déclipsez les sangles autour de la ceinture de taille.

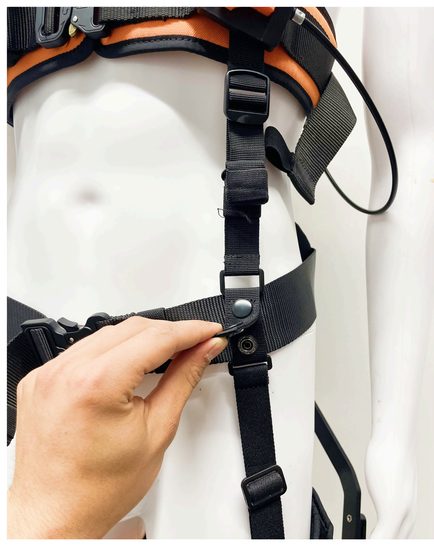

Côté droit

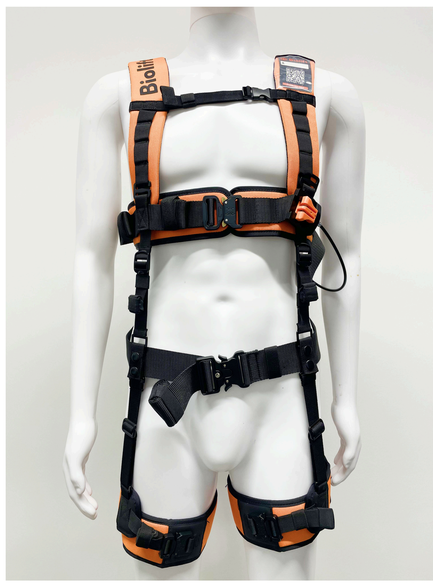

⚠️ Veuillez faire attention aux côtés de l'exosquelette lorsque vous retirez les tissus.

Côté gauche

Retirez l'ensemble du bouton marche/arrêt en le faisant glisser vers le haut à partir de la ceinture pectorale.

Retirez les bandes Velcro.

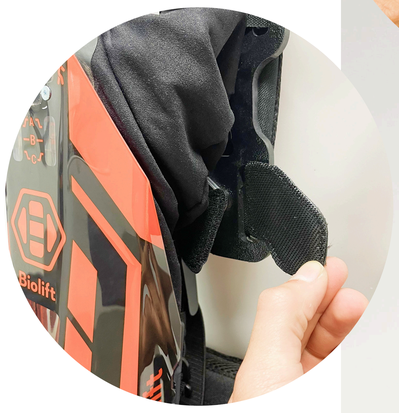

Détachez les sangles d'épaule et celles de la plaque arrière.

⚠️ Le Velcro et les boutons pression de la plaque arrière passent tous les deux par la même fente.

Retirez la ceinture

Détachez la plaque lombaire.

Retirez les sangles de cuisse en les faisant passer dans la fente.

Détachez un seul côté de la sangle élastique qui relie les deux sangles de cuisse.

⚠️ La sangle passe à travers cet axe.

⚠️ Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour les instructions de nettoyage.

Avez-vous des problèmes avec votre exosquelette ?

Consultez notre page de support ou contactez-nous!

Page de support: biolift.co/support

Contact:
+1-888-404-9853
support@biolift.co

Site Web: biolift.co